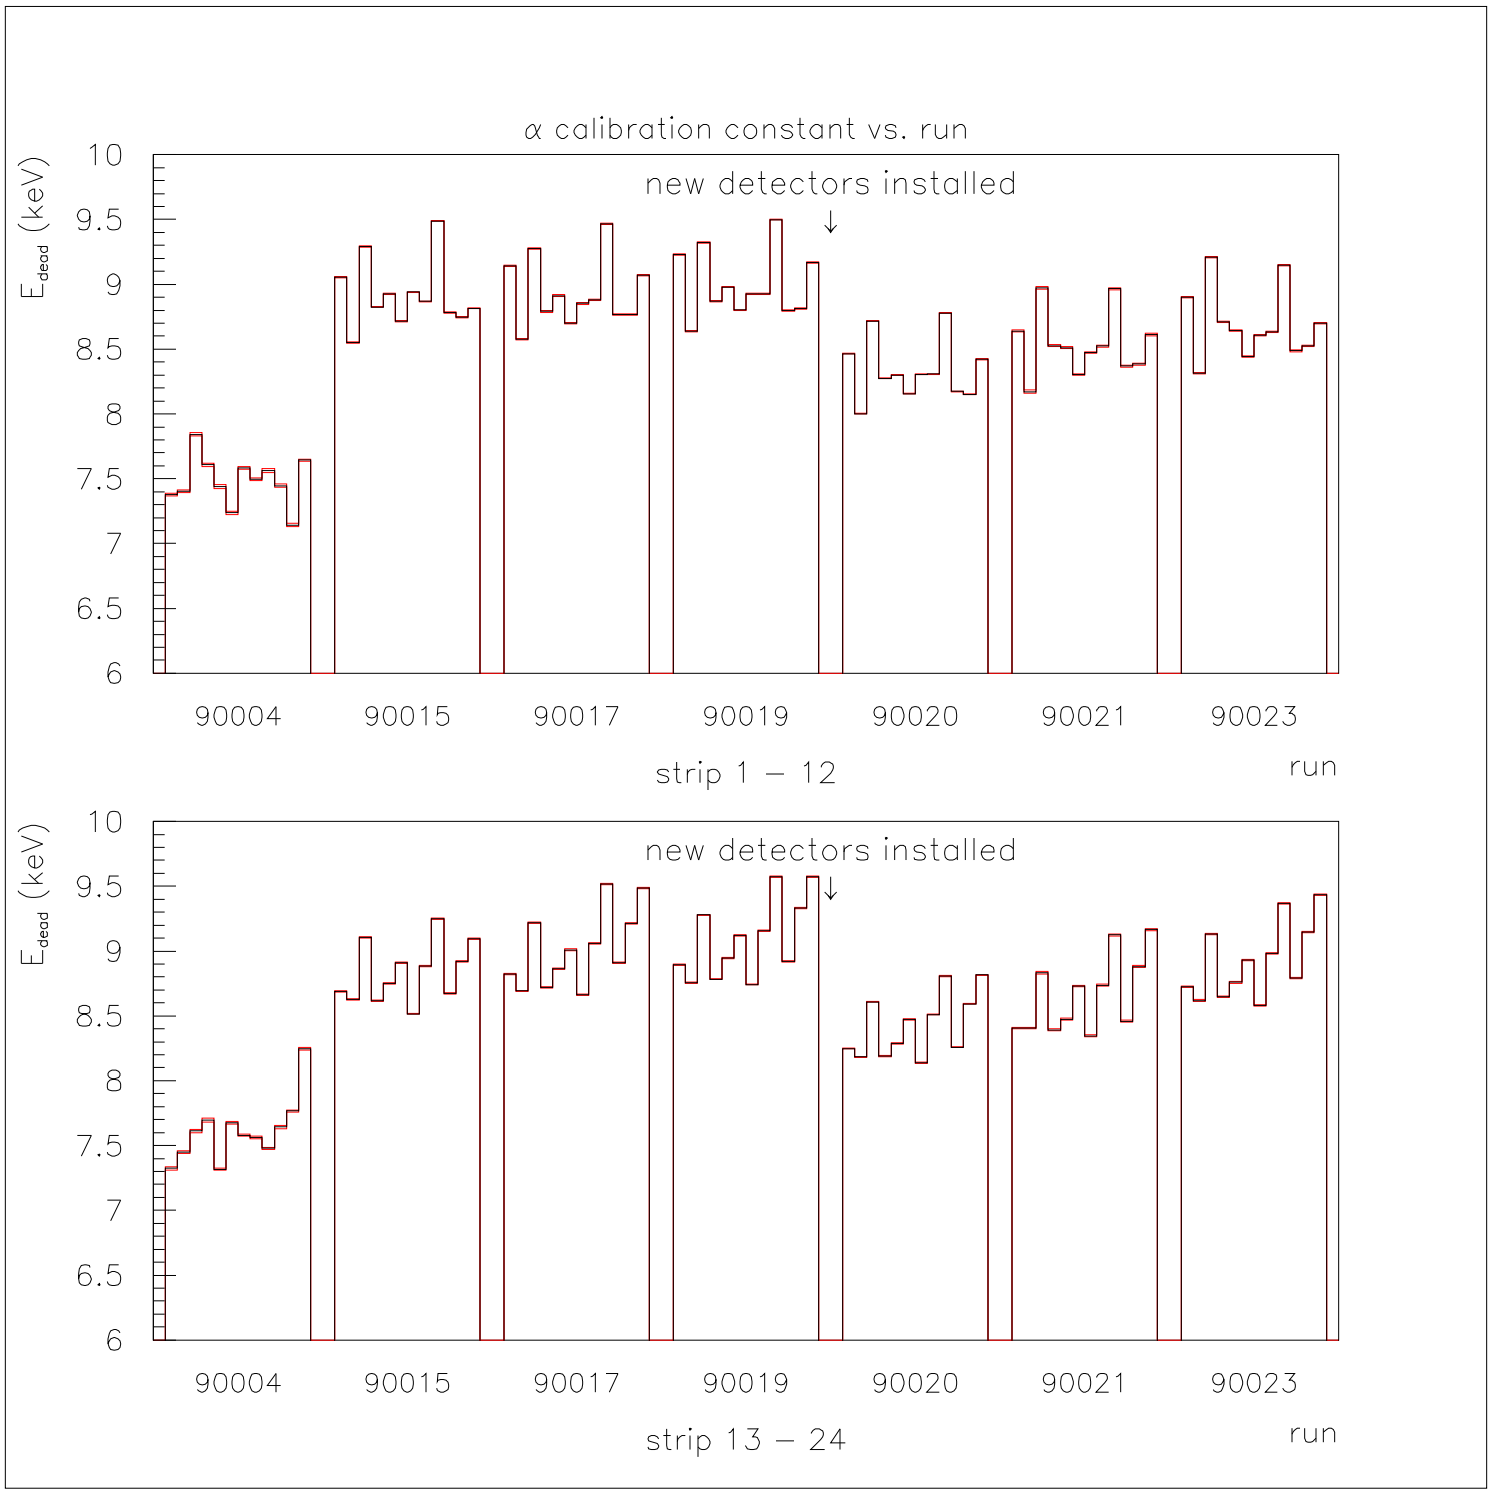
α calibration constant vs. run
new detectors installed
E_{dead} (keV)
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
90004
90015
90017
90019
90020
90021
90023
strip 1 – 12
run
new detectors installed
E_{dead} (keV)
strip 13 – 24
run

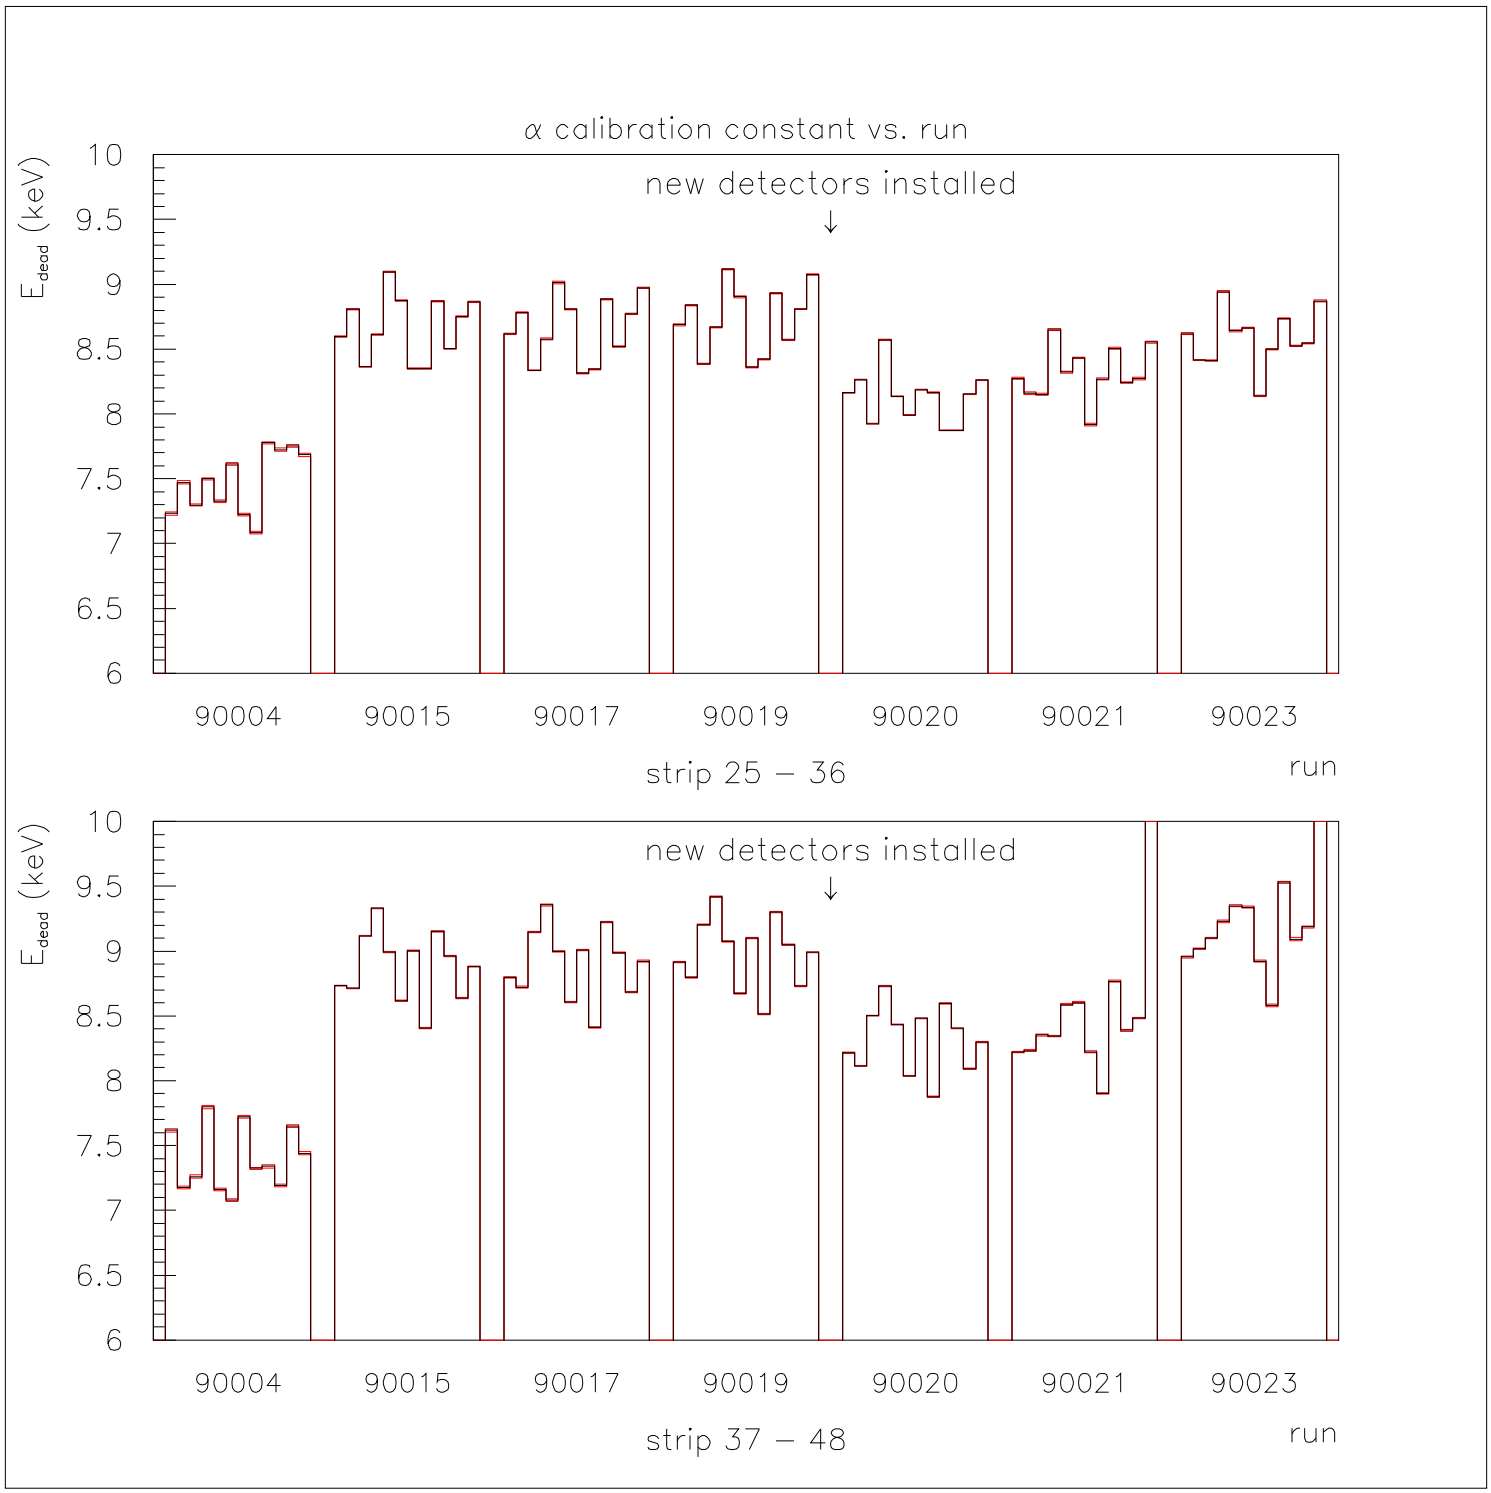
α calibration constant vs. run
new detectors installed
E_{dead} (keV)
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
90004
90015
90017
90019
90020
90021
90023
strip 25 – 36
run
new detectors installed
E_{dead} (keV)
strip 37 – 48
run